


PARECER TÉCNICO

Muriaé/MG, 11 de dezembro de 2025.

Processo: Cotação Prévia de Preços 016/2025

Encaminhem-se os autos, em atendimento à solicitação dos catálogos e propostas das empresas vencedoras, para análise técnica dos produtos referente ao Processo 016/2025, segue:

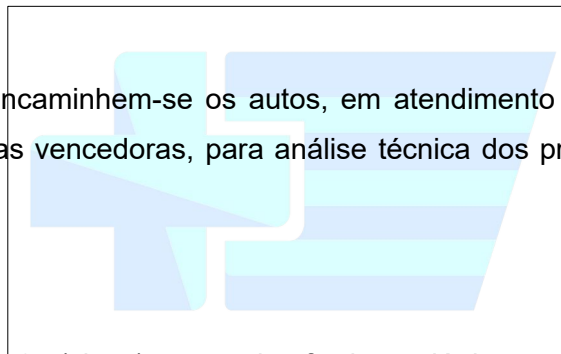

OBJETO: aquisição de 05 (cinco) camas tipo fawler – elétrica para UTI

EMPRESA: MEDI SAUDE

ITEM 1: CAMA FOWLER ELÉTRICA TT 04 MOT SUP GD

PROPONENTE: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

PRODUTO OFERTADO: Marca: MEDI SAÚDE, Fabricante: MEDI SAÚDE; Modelo: MS-11.003 SF 2 TT, ANVISA: 80881050010

ANÁLISE: A empresa **MEDI-SAUDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **02.563.570/0001-15**, apresentou cotação referente à **Cama Fowler Elétrica TT 04 MOT SUP GD**, modelo **MS-11.003 SF 2 TT**, registrada na ANVISA sob o nº **80881050010**. Contudo, o produto ofertado não atende às características exigidas no Termo de Referência do

Edital, bem como não contempla os documentos requeridos no presente item, razão pela qual sua proposta encontra-se em desacordo com as especificações editalícias.

Exigências solicitados no TERMO DE REFERÊNCIA que NÃO foram apresentados pelo proponente:

** Documento que comprova o TESTE SALT SPRAY 1.200 HORAS LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO;*

A empresa apresentou um ensaio Salt Spray com duração de 1.320 horas; entretanto, verificou-se que o certificado apresentado não foi emitido por laboratório acreditado, conforme os requisitos do INMETRO, o que compromete sua rastreabilidade, validade e confiabilidade técnica.

Desta forma, o documento não atende ao que foi exigido no edital, o qual solicita comprovação laboratorial idônea, reconhecida e rastreável, garantindo a confiabilidade da pintura anticorrosiva ofertada.

A informação foi confirmada por meio da consulta ao site oficial de laboratórios acreditados do INMETRO: <http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/>

Conforme verificado, a empresa HI-TEC Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda, responsável pelo certificado apresentado, não possui acreditação junto ao INMETRO.

Por que o teste Salt Spray precisa ser realizado por laboratório acreditado (INMETRO)?

O ensaio de Salt Spray é um teste de corrosão acelerada que **só possui validade técnica e legal** quando realizado em laboratório que segue padrões de qualidade, rastreabilidade e metodologia reconhecida internacionalmente.

Um laboratório **acreditado pelo INMETRO** garante:

- 1. Confiabilidade dos resultados**, seguindo rigor técnico da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.
- 2. Rastreabilidade dos equipamentos e insumos utilizados** no ensaio.

3. Imparcialidade e reconhecimento oficial, evitando certificados produzidos sem controle ou sem metodologia adequada.

Portanto, sem a acreditação, o certificado não cumpre o requisito de comprovação técnica exigido no edital, tornando a proposta **DESCCLASSIFICADA** neste critério.

Modelo apresentado – divergência de registro

O modelo apresentado foi **MS-11.003 SF 2 TT**, mas ao analisar o registro e o manual da empresa, **não foi localizado tal modelo**, impedindo a validação adequada do produto. Mesmo assim, realizamos a análise técnica de todos os modelos registrados pela empresa, sendo constatado que **nenhum deles atende ao descritivo mínimo do edital**.

Dessa forma, entendemos que o produto ofertado para o **ITEM 1 não atende ao descritivo do Termo de Referência do Edital**

EMPRESA META MÓVEIS:

ITEM 1: CAMA FOWLER ELÉTRICA 4 MOTORES MODELO:MT-165

PROPONENTE: META MÓVEIS DE METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PRODUTO OFERTADO: Marca: META MOVEIS, Fabricante: META MOVEIS; Modelo: MT-165, ANVISA: 80581990009

ANÁLISE: A empresa **META MÓVEIS DE METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **01.866.388/0001-70**, apresentou cotação referente à **Cama Fowler Elétrica 4 MOTORES**, modelo **MT-165**, registrada na ANVISA sob o nº 80581990009. O produto ofertado atende às características exigidas no Termo de Referência do Edital, bem como contempla os documentos requeridos no presente item, razão pela qual sua proposta encontra-se em acordo com as especificações editalícias.

Eng. Thadeu Oliva

Coordenador de Engenharia Clínica

Insc. Est. 439.032.362.00-71 / CNPJ 22.780.498/0001-95
Tel.: (32) 3729-3700 / Caixa Postal: 153
Rua Cel. Izalino, 187, Centro - Muriaé-MG - CEP: 36.880-103
Site: www.hsp.org.br

Casa de Caridade Muriaé Hospital São Paulo

M

H

